

MINI-SYSTEM

**RACCOLTA, FISSAZIONE
E CONCENTRAZIONE DEI PARASSITI**

NEW!
**FISSATIVO
NON PERICOLOSO**



- Sistema chiuso
- Due filtri
- Biglie di miscelazione
- Dimensioni contenute
- Non si usa Acetato di Etile
- Fissativo ECO-SAF o PARAGREEN



FILTRAZIONE E CONCENTRAZIONE DEI PARASSITI

Sistema chiuso

Flacone con spatola per la raccolta del campione e biglie di vetro che favoriscono l'omogenizzazione del campione fecale. Il sistema chiuso impedisce perdite ed odori.

Doppio sistema filtrante

Migliora la filtrazione delle feci trattenendone le impurità, il sedimento pulito facilita la lettura al microscopio.

Filtrazione

La filtrazione è ottenuta per centrifugazione eliminando così la necessità di aggiungere Acetato di Etile.

Dimensioni ridotte

Il Mini-System è utilizzabile in una centrifuga standard da laboratorio. Riduce lo spazio di stoccaggio e i costi di smaltimento.


Fissativo ECO-SAF

Fissativo Formalina Sodio Acetato (SAF) a basso contenuto di formaldeide.



Fissativo Paragreen

Il fissativo Paragreen non contiene formalina, alcool e metalli pesanti. È classificato come non pericoloso.

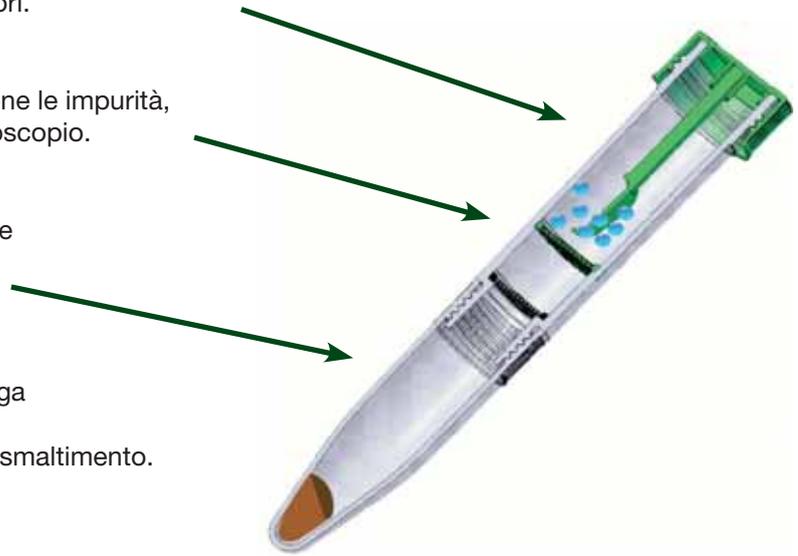

PROCEDURA

1 Agitare vigorosamente per 30 secondi il contenitore nel quale si è raccolto il campione.



2 Mantenendo il Mini-System capovolto, sostituire il tappo inferiore con il cono di sedimentazione.



3 Centrifugare per 3 minuti a 700 xg (2000 rpm).



4 Raccogliere il sedimento con una pipetta, depositare alcune gocce su un vetrino ed osservare al microscopio.



CONFEZIONE

REF 25RPP2000 Mini-System Ecosaf 150 tests
REF 25RPP7000 Mini-System Paragreen 150 tests



Biolife

Biolife Italiana srl - Viale Monza 272, 20128 Milano - Tel. 02 25209.1 - www.biolifeitaliana.it

